



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo

Processo Licitatório nº. 054/2017

Pregão Presencial nº. 026/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de equipamentos para unidade de pronto atendimento – UP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes dos Anexos I - Termo de Referência do edital.

A empresa Air Liquide Brasil Ltda, protocolou impugnação aos termos do edital do Pregão Presencial nº. 026/2017, sob nº. 14011/2017 no dia 28 de novembro de 2017, onde questiona:

- a) Que o descritivo do item 1 do edital restringiria a participação de concorrentes e que algumas características técnicas são insuficientes para tal finalidade;
- b) Que o descritivo do item 3 do edital não atenderia as aplicações clínicas exigidas pela Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica, de 2013;

Após análise do parecer técnico encaminhado pela Diretora Municipal de Saúde, Sra. Rivanilce de Souza Oliveira, e após parecer do Assessor Jurídico - Sr. Wilson Capatto Júnior, decido que a Impugnação apresentada pela empresa, é parcialmente procedente com referência ao Item 03 e Improcedente em relação ao Item 01, nos moldes da CI nº. 568/2017.

Decido acolher parcialmente a solicitação de impugnação, e Decido pela alteração no descritivo dos itens 03 e 79, nos moldes da CI nº. 568/2017, da Diretora Municipal de Saúde, datada de 30 de novembro de 2017, na forma que segue:

“Item nº. 03 - Cota Principal, e Item nº. 79 - Cota Reservada”

“VENTILADOR PULMONAR P/ TRANSP.

Ventilador pulmonar de transporte especificações técnicas mínimas: Ventilador pulmonar microprocessador para insuficiência respiratória de paciente adulto/pediátrico, a partir de 5kg em transporte de alta complexidade/resgate. Deve possuir fonte que realize comutação automática entre 100 a 240V, entrada própria para utilização em tomada 12 a 15V do tipo veicular, possibilidade futura de baterias intercambiáveis com autonomia de 2 horas cada, possuir bateria interna recarregável com autonomia de mínima de 1 hora. Deve possuir fonte própria de ar que dispense qualquer uso de rede de ar comprimido; Apresentar as seguintes



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo

modalidades ventilatórias: Ventilação assistido/controlada a volume (VCV/AC); Ventilação Assistido Controlada à Pressão (PCV/AC); Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV) a Volume (SIMV/V) e a Pressão (SIMV/P); Ventilação com Pressão de Suporte (PSV); Deve possuir modo de ventilação não Invasivo (VNI) com botão dedicado. Ventilação de Back-up em todos os modos espontâneos, no caso de apneia. Deve apresentar no mínimo os seguintes controles para ajuste direto pelos usuários: Volume corrente mínimo de 50 a 2000 ml; Pressão controlada no mínimo de 01 a 80 cm H₂O; Pressão de Suporte ajustável acima da PEEP de no mínimo 01 a 50 cmH₂O, Peep Interna ajustável de 0 a 20 cmH₂O; Concentrações de Oxigênio de 21 a 100%, **Tempo inspiratório**, Sensibilidade a pressão mínimo de 1 cmH₂O a 5 cmH₂O ou Sensibilidade a Fluxo de no mínimo 1 a 5 lpm; Controle para envio de 100% de O₂ por no mínimo 2 minutos com desligamento automático; **O equipamento poderá ou não conter botão que fará o fluxo manual com função ambu.** Fluxo inspiratório espontâneo de no mínimo até 150lpm; Pausa Inspiratória para monitorização de pressão de platô e complacência estática, Manobra de Pausa expiratória para monitorização da auto-peep; Botão de bloqueio de funções/teclado. Apresentar alarmes audiovisuais para os seguintes parâmetros: baixo volume minuto expirado, alta e baixa pressão inspiratória de pico, frequência respiratória alta, ventilador inoperante, baixa e alta pressão de O₂, bateria baixa e desconexão da energia elétrica. Apresentar monitorização para os seguintes parâmetros: Pressão máxima das vias aéreas, pressão média, Frequência respiratória, Volume corrente expirado, Relação I:E, Pico de Fluxo calculado, Esforço Paciente. O aparelho deve ter o peso máximo de 7,0 kg com bateria interna, deve possuir alça para transporte. Acompanha: 02 Circuitos pediátricos, 02 circuitos adultos completo, cabo de força; mangueira de oxigênio.

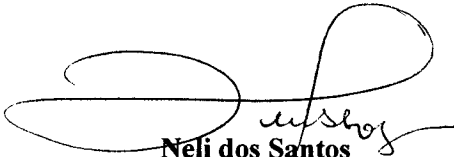
Assegura-se aos licitantes o direito de vistas dos autos.

Efetuar as alterações no edital, marcar nova data para a sessão pública.

Comunique-se aos interessados, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mongaguá, nos termos da Lei Municipal nº. 2.865/2017, e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br.

Atenciosamente.

Mongaguá, 14 de Dezembro de 2017


Neli dos Santos
Pregoeira